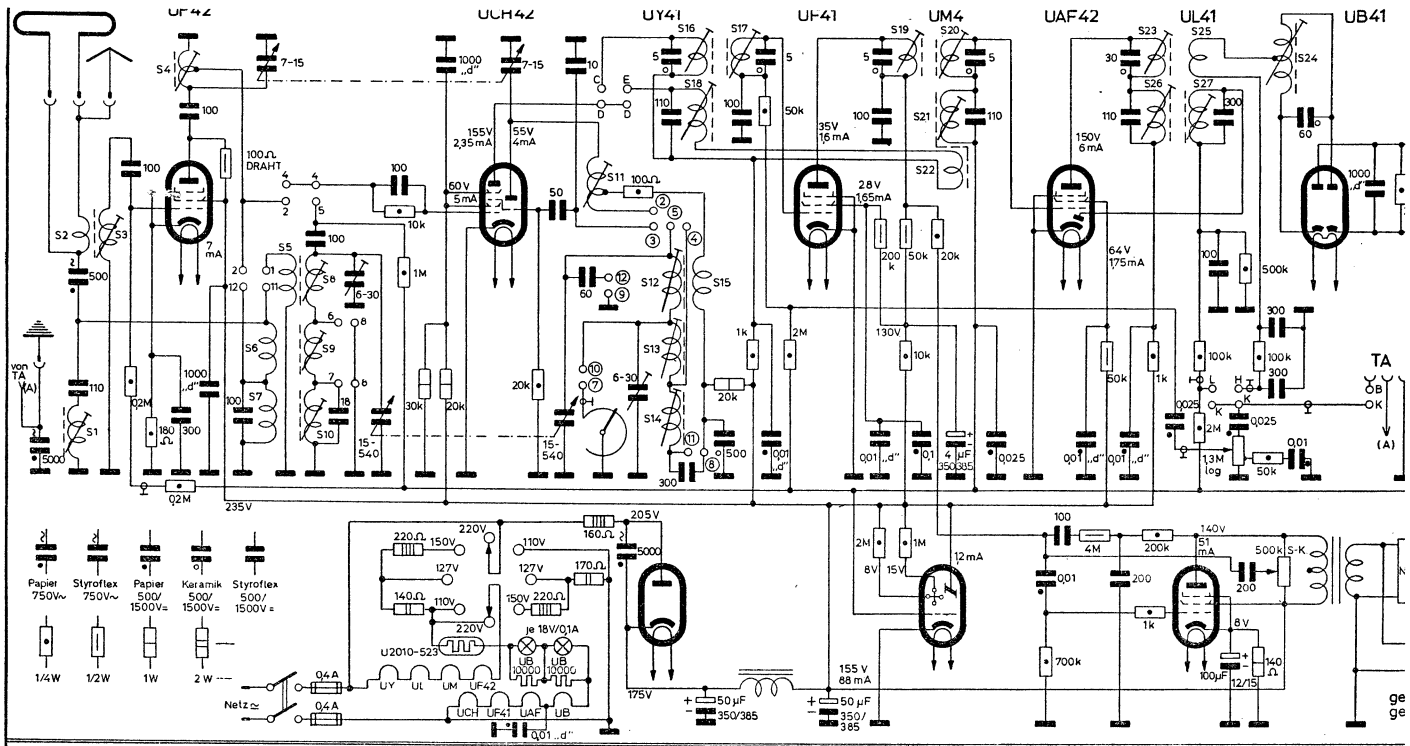
UF42
UCH42
UY41
UF41
UM4
UAF42
UL41
UB41
Samtliche Spannungen (u. Strome) sind auf UW mit Instrument 333Ω/V im 300V-Bereich gemessen.
1.Paket
2.Paket
3.Paket
L-Abgleich UKW-Vorkr.
L-Abgleich UKW Oscill.
gez. Stellung UKW-Linksanschlag
Pos 1-4 AM-ZF=473kHz
Pos 5-10 FM-ZF=10,7MHz
AM-ZF 473kHz
FM-ZF 10,7MHz
UKW L ca.90MHz M ca.90MHz K ca.90MHz
KW 6MHz
MW 550kHz 1500kHz
LW 200kHz
S1 240/20x0,05 LS
S2 2/0,5 Cu, isol.
S3 3/1,5 Cu, versilb.
S4 ca.3/1,5 Cu, versilb.
S5 35/0,15 LS
S6 400/0,09 LS
S7 700/0,09 LS
S8 7½/0,3 LS
S9 95/20x0,05 LS
S10 320/0,09 LS
S11 ca.3½/1,5 Cu, versilb.
S12 6/0,3 LS
S13 14,5/0,15 LS
S14 71/0,15 LS
S15 ca.6/0,09 LS
S16 24/0,15 LS
S17 32/0,15 LS
S18 2x129/20x0,05 LS
S19 32/0,15 LS
S20 32/0,15 LS
S21 2x129/20x0,05 LS
S22 5/20x0,05 LS
S23 18/0,15 LS
S24 7+7/0,15 LS
S25 6/0,15 LS
S26 2x129/20x0,05 LS
S27 155/20x 0,05 LS
Ausgangstrafo
Primär 2x1250/0,15
Sekundär 100/0,7
LOEWE OPTA „METEOR 52" mit Ratio-Detektor